

EXIT

Henrik Jörnvall
Karolinska Universitetssjukhuset

43²¹⁴


4

EX utero
Intrapartum
Treatment

14

1989

11





Uterusrelaxation

Navelsträngsflöde

Fetal anestesi









MAQUET



Musson
Pressure Plus
50ml

Glukos Braun
25 mg/ml buffrad
NIVUO 0



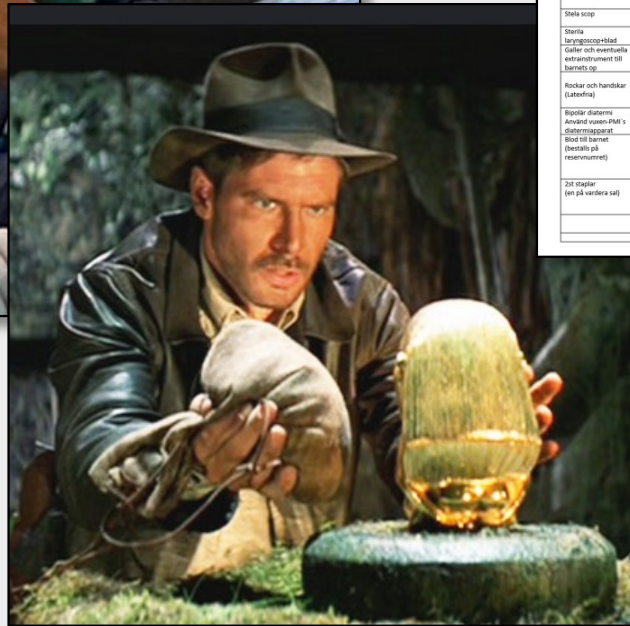

Tidsregistrering

Printa och använd denna mall för tidsregistrering och för sedan in i journal.

Induktion: _____

Hudincision: _____

Uterotomi: _____

Kantsutur, uterus: _____

Extrauterint barn: _____

Avnavling: _____

Suturerad uterus: _____

Förband: _____

Extubation: _____

Bilder på slangarna för diffundering av uterus



1. Ta fram 2 st spölet klipp av det ena strax under kammaren och koppla ihop det med 1 st spölet till.



2. Klipp av änden med rippel och mjuk slang. 3. Endotrachealtub 4.5



4. Klipp bort kuffslangen.



5. Koppla ihop spölet och endotrachealtub. sätt på 2 st varma ringreostat. Förbered ca 15-20 st i värmskäp.

6. Använd handkraft för att öka trycket på plåarna eller operations övertrycksapparat.

Barn-og ombesörjer	NEO ombesörjer	Fostermedicin ombesörjer	Aktivering av väsen
Lufthögtryck + barnsup	Saturationsmaskin till barn (kan steriliseras i sterilt)	Ultrajudmaskin	Kopparvillgaffel Grund 1
Flexibla scop	Övervakning till barnet Ev. INVOS	3 st Autosturta PREMIUM POLY CS 57.	1 st Sectiset 2 st 75cm 2 st spölet 60V;14TT 3 vag och diaploe 4 kassbandband 2 18-ståkan
Stäla scop	Läkemedel till barnet (för drags upp sterilt)		Övertrycksapparat
Stavla	Pvk nålar till barnet		2 st Resorlogar
långgropscykel			
Gaffel och eventuella extrainstrument till barnets op.	Barnbord		2 st Huggapparater varav en med finklippning
Rockar och handskar (Latexfri)			"Quackmaskin" till ultrajudmaskinen
Bipolar diatermi			Ultrajudstrumpa
Arvidet väsen till's diatermiapparat			Monopolär diatermi Diatermiapparat (1 med)
Blod till barnet (beställa på reservnivå)			Rockar och handskar Ladda med extra mycket AG och 7 bäble enkla och färdiga (Latexfri)
20 staplar (en på vardera sida)			2 st Brain Vivory CTX 1 st 3-0 CT. 1 1 st 2-0 PDS 1 st 3-0 Monocryl 45
			Värma ringreostat 15-20 st
			Blod till mamman

Uterusrelaxation

Navelsträngsflöde

Fetal anestesi

SW:4.9

VUXEN

FiSEV: Högt

00:20

01:18:29

VKTS

EiSEV: Högt

Högt kontinuerligt MAC

MANUELL

P _{topp} (cmH ₂ O)	20	PEEP (cmH ₂ O)	7
MV _T (l/min)	9.0	C _{dyn} (ml/cmH ₂ O)	36
VT _I (ml)	406	VT _e (ml)	394
MVe (l/min)	8.7	Frekvens (and./min)	22



CO ₂ (kPa)	0.0	Et (kPa)	4.2
O ₂ (%)	57	SEV (%)	7.4
		SEV (%)	6.0

MAC Brain 2.7
Ålder: 51
MAC Y 2.7

APL SP
Gasmix O₂/LUFT

Färskgasflöde 3.0 l/min

O₂ konc. 60 %

Sevofluran 8.0 %

PEEP 7 cmH₂O

Frekvens 22 and./min

Tidalvolym 400 ml

MAQUET

Larm-profil

Starta fall Avsluta fall

Spara skärm Trender

Start Stop Noll-ställ

Skärm layout Meny



